

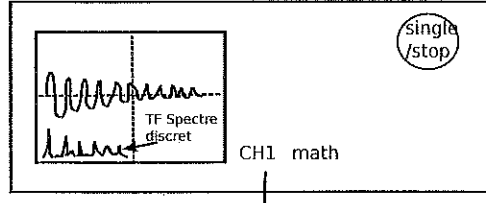
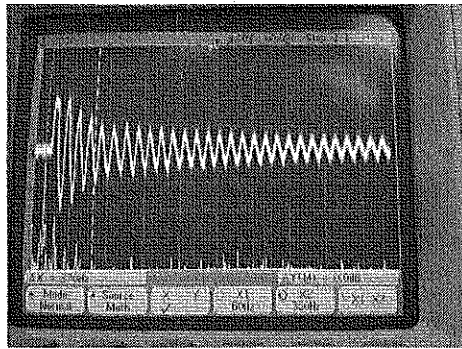


Modes propres d'une corde pincée : mise en évidence du spectre discret

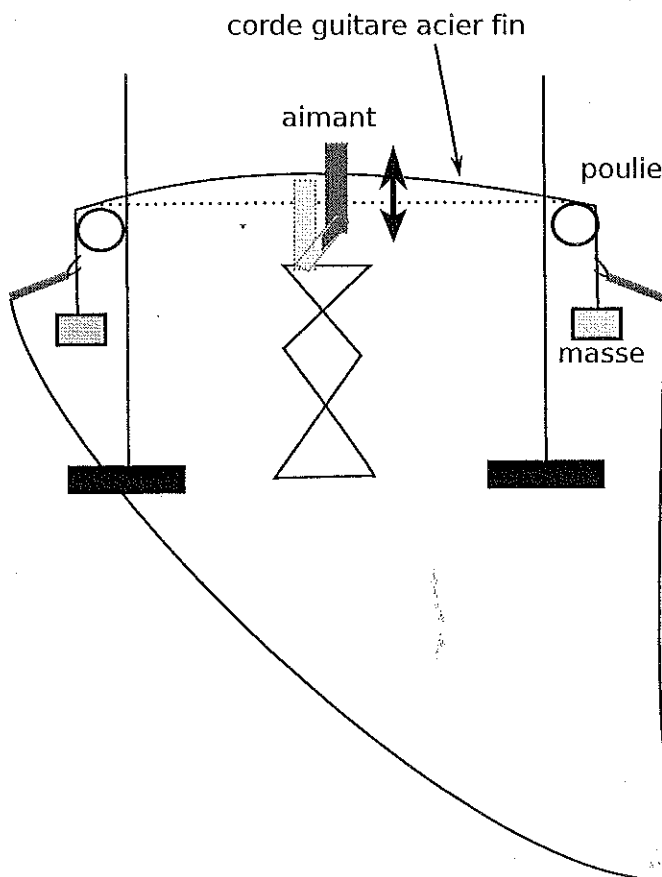

oscillo Agilent



ou vers  
analyseur de spectre

- A l'analyseur de spectre :
- Trigger sur channel 1
  - Average 10 fois (=10 pincées/lachers de corde à faire)
  - Span entre 0 et 400Hz

